

medika

CATÁLOGO DE

PRODUTOS

medika

CATÁLOGO DE
ENDOSCOPIA

Cânula com Alça

para Polipectomia Medika

Informações técnicas:

Indicada para retirar pólipos ou tecido no trato gastrointestinal mediante corrente elétrica de alta frequência.


O corpo da cânula é um tubo fabricado em aço inoxidável trançado, muito flexível, e revestido em PTFE para reduzir a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível no diâmetro externo de 2,3 mm, para canal de trabalho do endoscópio com 2,8 mm, por 1600, 1800 e 2300 mm de comprimento. A alça é fabricada em aço inoxidável, nos formatos crescente, hexagonal e oval, com largura de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50 mm. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear. Possui conector eletrodo monopolar, para conectar-se ao gerador de alta frequência.



MODELO ALÇA OVAL



MODELO CRESCENTE



MODELO HEXAGONAL



Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika®
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia Medika

MODELO ALÇA OVAL			
CÓDIGO	DIÂMETRO (mm) DO TUBO	COMPRIMENTO (mm) DO TUBO	LARGURA DA ALÇA (mm)
MAP2316010A	2.3	1600	10
MAP2318010A	2.3	1800	10
MAP2323010A	2.3	2300	10
MAP2316015A	2.3	1600	15
MAP2318015A	2.3	1800	15
MAP2323015A	2.3	2300	15
MAP2316020A	2.3	1600	20
MAP2318020A	2.3	1800	20
MAP2323020A	2.3	2300	20
MAP2316025A	2.3	1600	25
MAP2318025A	2.3	1800	25
MAP2323025A	2.3	2300	25
MAP2316030A	2.3	1600	30
MAP2318030A	2.3	1800	30
MAP2323030A	2.3	2300	30
MAP2316035A	2.3	1600	35
MAP2318035A	2.3	1800	35
MAP2323035A	2.3	2300	35
MAP2316040A	2.3	1600	40
MAP2318040A	2.3	1800	40
MAP2323040A	2.3	2300	40
MAP2316045A	2.3	1600	45
MAP2318045A	2.3	1800	45
MAP2323045A	2.3	2300	45
MAP2316050A	2.3	1600	50
MAP2318050A	2.3	1800	50
MAP2323050A	2.3	2300	50

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cânula com Alça

para Polipectomia Medika

MODELO ALÇA CRESCENTE			
CÓDIGO	DIÂMETRO (mm) DO TUBO	COMPRIMENTO (mm) DO TUBO	LARGURA DA ALÇA (mm)
MAP2316010C	2.3	1600	10
MAP2318010C	2.3	1800	10
MAP2323010C	2.3	2300	10
MAP2316015C	2.3	1600	15
MAP2318015C	2.3	1800	15
MAP2323015C	2.3	2300	15
MAP2316020C	2.3	1600	20
MAP2318020C	2.3	1800	20
MAP2323020C	2.3	2300	20
MAP2316025C	2.3	1600	25
MAP2318025C	2.3	1800	25
MAP2323025C	2.3	2300	25
MAP2316030C	2.3	1600	30
MAP2318030C	2.3	1800	30
MAP2323030C	2.3	2300	30
MAP2316035C	2.3	1600	35
MAP2318035C	2.3	1800	35
MAP2323035C	2.3	2300	35
MAP2316040C	2.3	1600	40
MAP2318040C	2.3	1800	40
MAP2323040C	2.3	2300	40
MAP2316045C	2.3	1600	45
MAP2318045C	2.3	1800	45
MAP2323045C	2.3	2300	45
MAP2316050C	2.3	1600	50
MAP2318050C	2.3	1800	50
MAP2323050C	2.3	2300	50

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cânula com Alça

para Polipectomia Medika

MODELO ALÇA HEXAGONAL			
CÓDIGO	DIÂMETRO (mm) DO TUBO	COMPRIMENTO (mm) DO TUBO	LARGURA DA ALÇA (mm)
MAP2316010B	2.3	1600	10
MAP2318010B	2.3	1800	10
MAP2323010B	2.3	2300	10
MAP2316015B	2.3	1600	15
MAP2318015B	2.3	1800	15
MAP2323015B	2.3	2300	15
MAP2316020B	2.3	1600	20
MAP2318020B	2.3	1800	20
MAP2323020B	2.3	2300	20
MAP2316025B	2.3	1600	25
MAP2318025B	2.3	1800	25
MAP2323025B	2.3	2300	25
MAP2316030B	2.3	1600	30
MAP2318030B	2.3	1800	30
MAP2323030B	2.3	2300	30
MAP2316035B	2.3	1600	35
MAP2318035B	2.3	1800	35
MAP2323035B	2.3	2300	35
MAP2316040B	2.3	1600	40
MAP2318040B	2.3	1800	40
MAP2323040B	2.3	2300	40
MAP2316045B	2.3	1600	45
MAP2318045B	2.3	1800	45
MAP2323045B	2.3	2300	45
MAP2316050B	2.3	1600	50
MAP2318050B	2.3	1800	50
MAP2323050B	2.3	2300	50

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

Informações técnicas:

Indicada para retirar pólipos ou outro tecido no trato gastrointestinal, sob visualização de um endoscópio.


A cânula com alça para polipectomia a frio possui diâmetro externo de 2.3 mm, para canal de trabalho do endoscópio maior ou igual a 2.8 mm, por 2350 mm de comprimento. O corpo da alça é um tubo fabricado em aço inoxidável trançado, muito flexível e revestido em polipropileno, que reduz a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. A empunhadura em ABS Lustran, é de fácil manipulação, podendo ser fixa ou giratória. A alça é fabricada em aço inoxidável, composta por fio de 0.4 ou 0.7 mm de diâmetro, disponível nos formatos oval, hexagonal ou diamante, com larguras de 05; 10, 15; 20; 25; 30; 35 e 40 mm de abertura.



MODELO ALÇA OVAL
FIXA OU GIRATÓRIA



MODELO HEXAGONAL
FIXA OU GIRATÓRIA



MODELO DIAMANTE
FIXA OU GIRATÓRIA



Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, FIXA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A009	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, FIXA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A010	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A011	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A012	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A013	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A014	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A015	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A016	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA HEXAGONAL, FIXA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-B001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA DIAMANTE, FIXA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-C001	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C002	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C003	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C004	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C005	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C006	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C007	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C008	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, GIRATÓRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A009-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A010-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA OVAL, GIRATÓRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-A011-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A012-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A013-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A014-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 30 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A015-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 35 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-A016-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato oval, com abertura de 40 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA HEXAGONAL, GIRATÓRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-B001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-B008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato hexagonal, com abertura de 25 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula com Alça

para Polipectomia a Frio Medika

MODELO: ALÇA DIAMANTE, GIRATÓRIA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
LQ-C001-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C002-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C003-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C004-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.4 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C005-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 05 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C006-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 10 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C007-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 15 mm, empunhadura ergonômica.
LQ-C008-R	01 cânula com alça para polipectomia com tubo com extensão de 2.3 mm de diâmetro externo por 2350 mm de comprimento, em aço inoxidável com fio de 0.7 mm, revestido em Polipropileno, com alça em formato diamante, com abertura de 20 mm, empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br


Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika


Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras do trato digestivo e respiratório através de canal de trabalho de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, muito flexível e revestido em polietileno, que reduz a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. A cúpula, em sua extremidade distal, é fabricada também em aço inoxidável, nos modelos oval e jacaré, com espícula, para fixação em tecido escorregadio ou sem espicula, com estrutura fixa ou giratória. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, de fácil manipulação. Disponível nos diâmetros 1.0, para canal de trabalho do endoscópio com 1.2mm; 1.8, para canal de trabalho do endoscópio com 2,0mm; 2.3 mm, para canal de trabalho do endoscópio com 2.8 mm e 3.0, para canal de trabalho do endoscópio com 3.2 mm, por 1050, 1200, 1600, 1800, 2300, 2700, 2900 mm de comprimento.

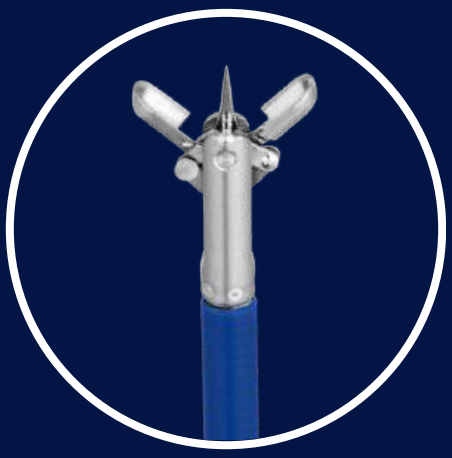

Modelo com ou sem espícula, fixa ou giratória, cúpula oval

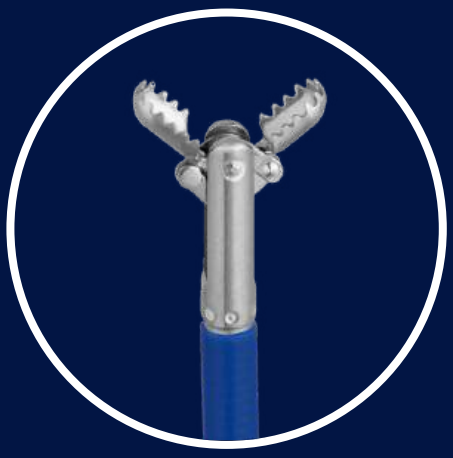

Modelo com ou sem espícula, fixa ou giratória, cúpula jacaré

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

MODELO SEM ESPÍCULA, FIXA	
Código	Descrição
CBF101-10105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10270	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10270	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10290	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10290	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-23120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-18160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30105	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30120	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30160	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-30180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30180	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30230	01 pinça endoscópica para biópsia sem espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

MODELO COM ESPÍCULA, FIXA	
Código	Descrição
CBF111-23105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF211-23180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF211-18230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30105	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30120	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30160	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30180	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30230	01 pinça endoscópica para biópsia com espícula, fixa, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

MODELO SEM ESPÍCULA, GIRATÓRIA	
Código	Descrição
CBF101-10105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10270R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10270R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2700 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-10290R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-10290R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.0 mm de diâmetro externo por 2900 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-23120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-23230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-23230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-18160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-18230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-18230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30105R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30120R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30160R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF101-30180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30180R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF101-30230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF201-30230R	Pinça endoscópica para biópsia sem espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

MODELO COM ESPÍCULA, GIRATÓRIA	
Código	Descrição
CBF111-23105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF211-23180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-23230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-23230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 2.3 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-18180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-18230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Medika

Código	Descrição
CBF211-18230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 1.8 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30105R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1050 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30120R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1200 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30160R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1600 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30180R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 1800 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF111-30230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula oval, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.
CBF211-30230R	Pinça endoscópica para biópsia com espícula, giratória, cúpula jacaré, com 3.0 mm de diâmetro externo por 2300 mm de comprimento em aço inoxidável revestido em polietileno, com empunhadura ergonômica.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica


para Biópsia Medika

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras do trato digestivo por meio do canal de trabalho endoscópico.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, muito flexível e revestido em polietileno, que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos diâmetros 1,8, para canal de trabalho do endoscópio com 2,0 mm, e 2,3 mm, para canal de trabalho do endoscópio com 2,8 mm, por 50, 120, 160, 180 e 230 cm de comprimento. Em sua extremidade distal, a pinça apresenta uma garra fabricada em aço inoxidável, disponível nos modelos com espícula para fixação em tecidos escorregadios ou sem espícula. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear.

MODELO SEM ESPÍCULA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO DA PINÇA
BF18-A18/50	1,8 mm	50 cm
BF18-A18/120	1,8 mm	120 cm
BF18-A18/160	1,8 mm	160 cm
BF18-A18/180	1,8 mm	180 cm
BF18-A18/180	1,8 mm	230 cm
BF18-A23/50	2,3 mm	50 cm
BF18-A23/120	2,3 mm	120 cm
BF18-A23/160	2,3 mm	160 cm
BF18-A23/160	2,3 mm	180 cm
BF18-A23/230	2,3 mm	230 cm

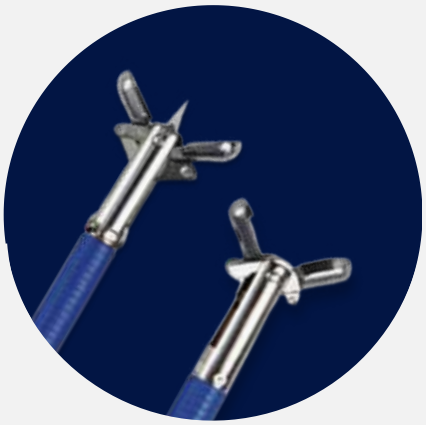

MODELO COM ESPÍCULA		
CÓDIGO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO DA PINÇA
BF18-A18/50-J	1,8 mm	50 cm
BF18-A18/120-J	1,8 mm	120 cm
BF18-A18/160-J	1,8 mm	160 cm
BF18-A18/180-J	1,8 mm	180 cm
BF18-A18/230-J	1,8 mm	230 cm
BF18-A23/50-J	2,3 mm	50 cm
BF18-A23/120-J	2,3 mm	120 cm
BF18-A23/160-J	2,3 mm	160 cm
BF18-A23/180-J	2,3 mm	180 cm
BF18-A23/230-J	2,3 mm	230 cm



Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Biópsia Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostra dos tratos digestivo e respiratório, por meio do canal de trabalho de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e revestido em polietileno para reduzir a fricção no canal do endoscópio. Disponível nos diâmetros de 1,8 mm, para o canal de trabalho do endoscópio de 2,0 mm, e 2,3 mm, para o canal de trabalho do endoscópio com 2,8 mm, em comprimentos de 1050 mm, 1600 mm, 1800 mm, 2000 mm e 2300 mm. Em sua extremidade distal, a pinça apresenta uma garra fabricada em aço inoxidável, disponível nos modelos com espícula para fixação em tecidos escorregadios ou sem espícula. A empunhadura é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear.

MODELO SEM ESPÍCULA		
CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA	COMPRIMENTO DA PINÇA
JHY-FB-23-160-O-P	2,3 mm	1600 mm
JHY-FB-23-180-O-P	2,3 mm	1800 mm
JHY-FB-23-200-O-P	2,3 mm	2000 mm
JHY-FB-23-230-O-P	2,3 mm	2300 mm
JHY-FB-18-105-O-P	1,8 mm	1050 mm
JHY-FB-18-160-O-P	1,8 mm	1600 mm
JHY-FB-18-230-O-P	1,8 mm	2300 mm



MODELO COM ESPÍCULA		
CÓDIGO	DIÂMETRO DA PINÇA	COMPRIMENTO DA PINÇA
JHY-FB-23-160-W-P	2,3 mm	1600 mm
JHY-FB-23-180-W-P	2,3 mm	1800 mm
JHY-FB-23-200-W-P	2,3 mm	2000 mm
JHY-FB-23-230-W-P	2,3 mm	2300 mm
JHY-FB-18-105-W-P	1,8 mm	1050 mm
JHY-FB-18-160-W-P	1,8 mm	1600 mm
JHY-FB-18-230-W-P	1,8 mm	2300 mm



Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica


para Apreensão com Rede Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicada para a remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e revestido em PTFE, para reduzir a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 1,8mm e 2,5 mm de diâmetro externo por 1600 e 2300 mm de comprimento. O laço em sua extremidade distal é fabricado em aço inoxidável e possui uma rede em nylon que facilita a captação do corpo estranho. Empunhadura de fácil manipulação, giratória, em ABS Lustran, que permite a rotação do laço.



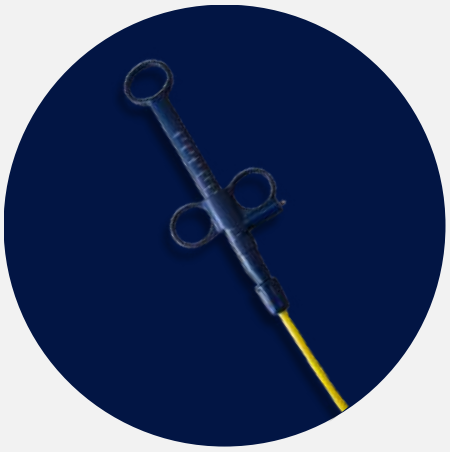

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	TAMANHO DO LAÇO	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO
JHY-FG-18-160-C1	1,8 mm	1600 mm	20 x 50 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C2	1,8 mm	1600 mm	25 x 55 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C3	1,8 mm	1600 mm	30 x 60 mm	2 mm
JHY-FG-18-160-C4	1,8 mm	1600 mm	40 x 75 mm	2 mm
JHY-FG-25-230-C1	2,5 mm	2300 mm	20 x 50 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C2	2,5 mm	2300 mm	25 x 55 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C3	2,5 mm	2300 mm	30 x 60 mm	2,8 mm
JHY-FG-25-230-C4	2,5 mm	2300 mm	40 x 75 mm	2,8 mm

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Apreensão Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicada para a remoção de corpos estranhos no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O corpo da pinça é fabricado em aço inoxidável, flexível e possui revestimento em PTFE, que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 2,3 mm de diâmetro externo por 1600, 1800 e 2300 mm de comprimento. A garra, localizada em sua extremidade distal, é fabricada em aço inoxidável, disponível em diversos modelos de apreensão, tais como dente de rato, jacaré, jacaré com dente de rato, pelicano, três pontas, quatro pontas e cinco pontas. A empunhadura é fabricada de ABS Lustran, fácil de manusear.

MODELO JACARÉ		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A1	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A1	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A1	2,3 mm	2300 mm

MODELO DENTE DE RATO		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A2	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A2	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A2	2,3 mm	2300 mm

MODELO JACARÉ COM DENTE DE RATO		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A3	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A3	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A3	2,3 mm	2300 mm

MODELO PELICANO		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-A4	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-A4	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-A4	2,3 mm	2300 mm



MODELO JACARÉ



MODELO DENTE DE RATO



MODELO JACARÉ COM DENTE DE RATO



MODELO PELICANO

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Pinça Endoscópica

para Apreensão Jiuhong Medical



MODELO 3 PONTAS

MODELO 3 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B1	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B1	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B1	2,3 mm	2300 mm



MODELO 4 PONTAS

MODELO 4 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B2	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B2	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B2	2,3 mm	2300 mm



MODELO 5 PONTAS

MODELO 5 PONTAS		
CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO
JHY-FG-23-160-B3	2,3 mm	1600 mm
JHY-FG-23-180-B3	2,3 mm	1800 mm
JHY-FG-23-230-B3	2,3 mm	2300 mm

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br


Cânula Endoscópica

para Injeção Medika

Informações técnicas:

Indicada para administrar medicamentos injetáveis no trato gastrointestinal com o auxílio de um endoscópio.

A cânula é composta por um tubo interno fabricado em polioximetileno e um tubo externo fabricado em PTFE, para reduzir a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Possui diâmetro de 2,4 mm e comprimentos de 160, 195 e 230 cm. Possui bainha proximal fabricada em poliuretano, responsável pelo acionamento da agulha, e uma trava de segurança, para evitar acionamentos acidentais. A extremidade distal da cânula é fabricada em aço inoxidável nos tamanhos 0.5, 0.6, 0.7 e 0.9 mm e 5 mm de comprimento e possui um reservatório de proteção. A empunhadura da cânula é fabricada em ABS Lustran, fácil de manusear.

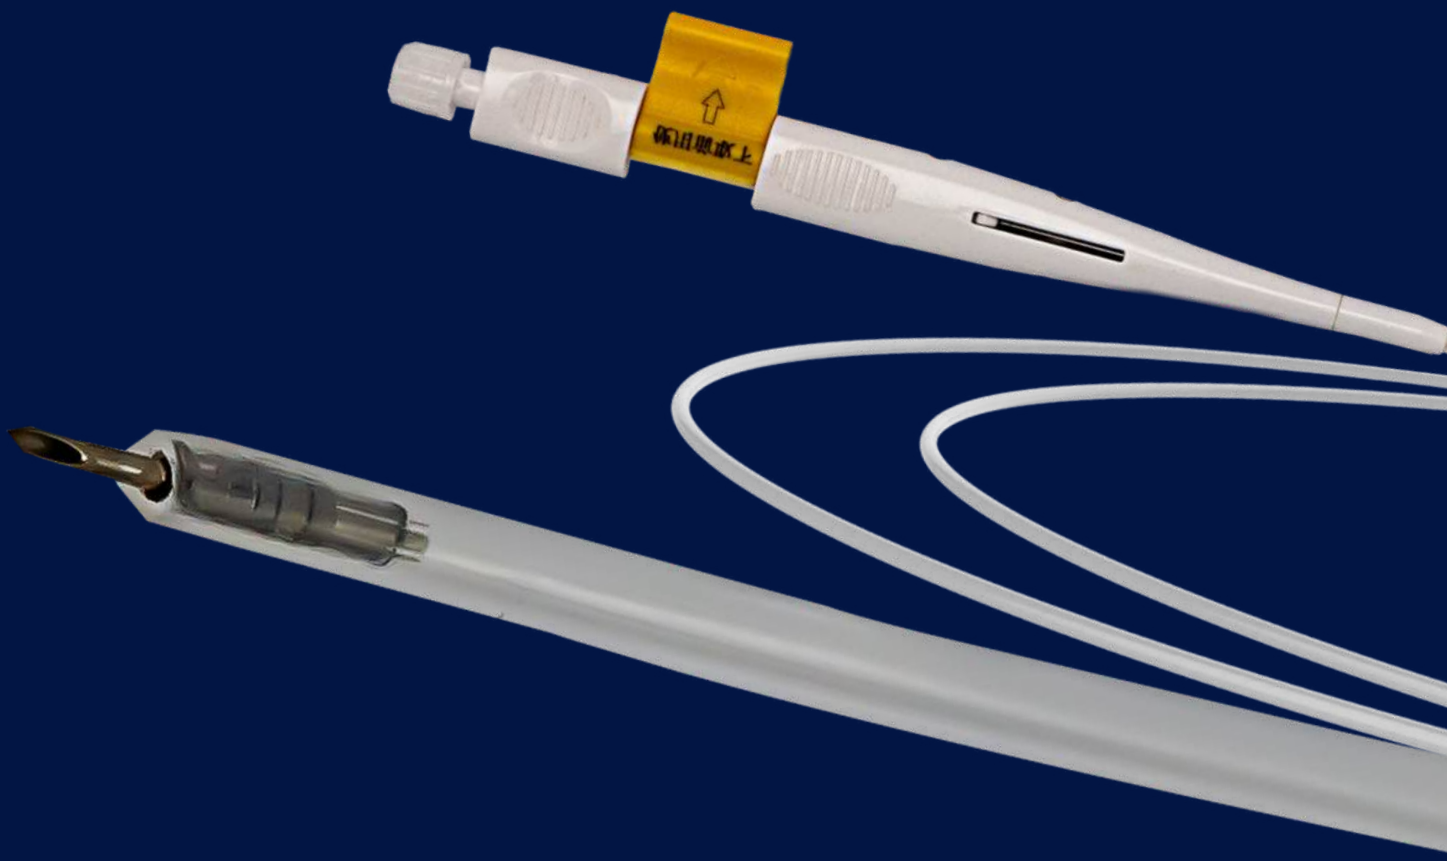

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cânula Endoscópica

para Injeção Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
SN18-05/160	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 160 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.5 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-07/160	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 160 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.7 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-09/160	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 160 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.9 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-05/195	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 195 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.5 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-07/195	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 195 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.7 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-09/195	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 195 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.9 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-05/230	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 230 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.5 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-06/230	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 230 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.6 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-07/230	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 230 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.7 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.
SN18-09/230	01 cânula endoscópica para injeção, com tubo externo da cânula em PTFE, com extensão de 2.4 mm de diâmetro externo por 230 cm de comprimento, com agulha em aço inoxidável com tamanho 0.9 mm, reservatório de proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cânula Endoscópica

para Injeção Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicada para administração de medicamentos injetáveis no trato gastrointestinal, com o auxílio de um endoscópio.

O tubo interno é fabricado em polioximetileno, e o tubo externo da cânula em PTFE, o que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio. Disponível nos tamanhos 1,8 mm e 2,3 mm de diâmetro por 1200, 1800, 2300 e 2600 mm de comprimento. A cânula possui uma bainha proximal fabricada em poliuretano, responsável pelo acionamento da agulha.

A extremidade distal da agulha é fabricada em aço inoxidáve, nos tamanhos 20x5, 22x5, 23x5, 25x5 e 22x4" e possui um reservatório de proteção. Empunhadura de fácil manipulação, em ABS Lustran.



Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Cânula Endoscópica

para Injeção Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂM. DA CÂNULA	COMP. DA CÂNULA	TAMANHO DA AGULHA	CANAL DE TRABALHO DE ENDOSCÓPIO
JHY-IN-18-120-2505-A	1.8 mm	1200 mm	25 X 5 mm	≥ 2.0
JHY-IN-18-120-2205-A	1.8 mm	1200 mm	22 X 5 mm	≥2.0
JHY-IN-18-180-2505-A	1.8 mm	1800 mm	25 X 5 mm	≥2.0
JHY-IN-18-180-2305-A	1.8 mm	1800 mm	23 X 5 mm	≥2.0
JHY-IN-18-180-2205-A	1.8 mm	1800 mm	22 X 5 mm	≥2.0
JHY-IN-18-260-2205-A	1.8 mm	2600 mm	22 X 5 mm	≥2.0
JHY-IN-23-180-2505-A	2.3 mm	1800 mm	25 X 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-180-2005-A	2.3 mm	1800 mm	20 X 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-180-2205-A	2.3 mm	1800 mm	22 X 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-230-2305-A	2.3 mm	2300 mm	23 x 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-230-2204-A	2.3 mm	2300 mm	22 x 4 mm	≥2.8
JHY-IN-23-230-2005-A	2.3 mm	2300 mm	20 x 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-230-2205-A	2.3 mm	2300 mm	22 x 5 mm	≥2.8
JHY-IN-23-260-2205-A	2.3 mm	2600 mm	22 x 5 mm	≥2.8

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

Cânula Fina para Biópsia


Ecoendoscópica Medika

Informações técnicas:

Indicada para coleta de amostras da mucosa do trato gastrointestinal, por meio do canal de trabalho de um ecoendoscópio. O uso de uma cânula fina para biópsia citológica por aspiração melhora a escolha do local da punção, tornando-a mais precisa.

Adequada para uso em ecoendoscópios rígidos e flexíveis, que possuam um canal de trabalho igual ou superior a 2.0 mm. Cânula ecogênica disponível nos diâmetros 19, 20, 22 e 25 G, com comprimento de 0 a 8 cm, bainha 1,7 mm de diâmetro externo por 70 e 140 cm de comprimento. Possui uma empunhadura ergonômica graduada, permitindo ajustar o comprimento da cânula e da bainha conforme necessário. Possui um mandril pré-inserido em nitinol, proporcionando maior flexibilidade durante o procedimento.



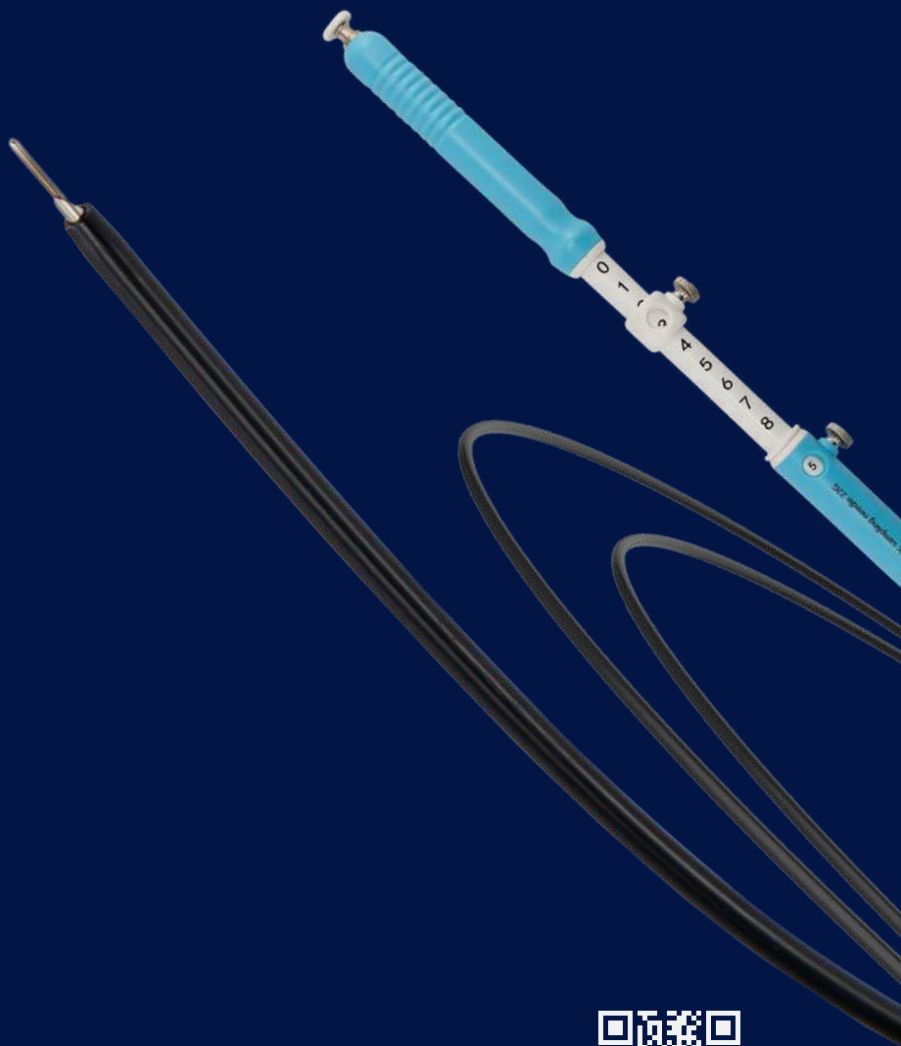

medika®

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

Cânula Fina para Biópsia

Ecoendoscópica Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
UN18-19/70	01 cânula 19G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 70 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-20/70	01 cânula 20G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 70 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-22/70	01 cânula 22G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 70 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml
UN18-25/70	01 cânula 25G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 70 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-19/140	01 cânula 19G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 140 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-20/140	01 cânula 20G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 140 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-22/140	01 cânula 22G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 140 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.
UN18-25/140	01 cânula 25G para biópsia ecoendoscópica, com comprimento da cânula de 0 a 8 cm, com bainha 1.7 mm de diâmetro externo por 140 cm de comprimento, empunhadura ergonômica graduada para ajuste do comprimento da cânula e da bainha e mandril previamente inserido. 01 seringa de vácuo com válvula de via dupla e trava de segurança, 20 ml.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China


Clip Endoscópico

Hemoclip Medika

Informações técnicas:

Indicado para posicionamento de clipe endoscópico em tecidos do trato gastrointestinal, em casos diversos. Pode ser utilizado para marcar procedimentos radiológicos e cirúrgicos, realizar hemostasia em sangramentos de úlceras, pólipos menores que 1,5 cm de diâmetro, tratar divertículos no cólon, ocluir artérias menores que 2 mm, tratar deficiências de mucosa e submucosa menores que 3 cm, e como método suplementar no fechamento de perfurações do trato luminal gastrointestinal menor que 20 mm.

O hemoclip é composto por um tubo fabricado em aço inoxidável, com diâmetro de 2,5 mm, por 1600, 1800 e 2300 de comprimento, revestido em polietileno (PE). Sua extremidade distal possui um clipe com abertura de 11,13 e 16 mm x 1600, 1800, 2300, mm de comprimento. O clipe possibilita a abertura quantas vezes forem necessárias para um melhor posicionamento na lesão. Possui capacidade de rotação em 360º, facilita o manuseio do profissional e proporciona maior segurança no posicionamento do clipe.

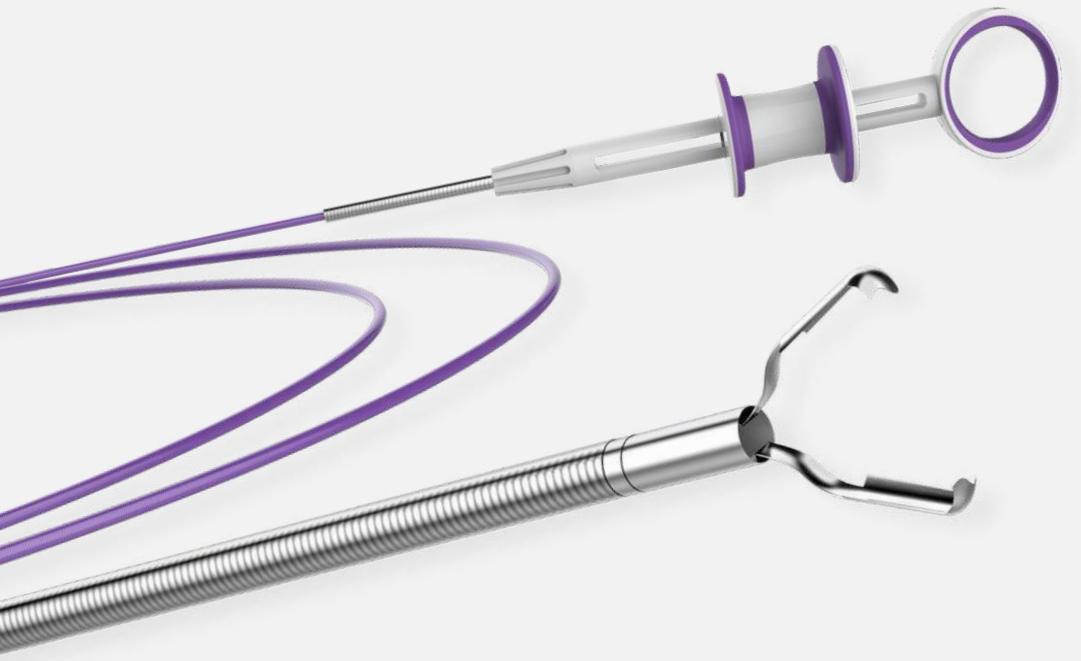

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

medika
www.medika.com.br

Clip Endoscópico

Hemoclip Medika

CÓDIGO	DIÂMETRO (mm) EXTERNO	COMPRIMENTO (mm)	ABERTURA DO CLIP (mm)	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCOPIO (mm)
MHE1125160	2.5	1600	11	›2.8
MHE1125180	2.5	1800	11	›2.8
MHE1125230	2.5	2300	11	›2.8
MHE1325160	2.5	1600	13	›2.8
MHE1325180	2.5	1800	13	›2.8
MHE1325230	2.5	2300	13	›2.8
MHE1625160	2.5	1600	16	≥2.8
MHE1625180	2.5	1800	16	≥2.8
MHE1625230	2.5	2300	16	≥2.8

Fabricante: HTS–Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda
País: Brasil

Cesto Endoscópico

CPRE

para Remoção de Cálculos Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicado para remoção de cálculos no ducto biliar, ou remoção de corpos estranhos no trato digestivo alto e baixo, com o auxílio de um endoscópio.

O tubo do cesto é fabricado em aço inoxidável 316, com 2.3 mm de diâmetro externo e 2000 mm de comprimento, sendo muito flexível e revestido em PTFE para reduzir a fricção do aço inoxidável no canal de trabalho do endoscópio. O cesto possui 16 cm de fio em nitinol que antecedem o cesto. Na extremidade distal, é composto de fios de nitinol, disponível nos formatos diamante ou espiral, composto de 4, 6 e 8 fios. A empunhadura é fabricada de ABS Lustran, fácil de manusear, e possui um injetor lateral para infusão de contraste.



CESTO EM FORMATO DIAMANTE



CESTO EM FORMATO ESPIRAL

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cesto Endoscópico

para Remoção de Cálculos Jiuhong Medical

MODELO NO FORMATO DE DIAMANTE COM 4 FIOS			
CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-22-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	22 mm
JHY-BAS-23-200-25-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	25 mm
JHY-BAS-23-200-30-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm
JHY-BAS-23-200-35-S4-A-D	2,3 mm	2000 mm	35 mm

MODELO NO FORMATO DE DIAMANTE COM 8 FIOS			
CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-S8-A-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-S8-A-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

MODELO NO FORMATO DE ESPIRAL COM 6 FIOS			
CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO DO TUBO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-N6-C-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-N6-C-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

MODELO: CESTO EM FORMATO DE ESPIRAL COM 08 FIOS			
CÓDIGO	DIÂMETRO DO TUBO	COMPRIMENTO DO TUBO	LARGURA DO CESTO
JHY-BAS-23-200-20-N8-C-D	2,3 mm	2000 mm	20 mm
JHY-BAS-23-200-30-N8-C-D	2,3 mm	2000 mm	30 mm

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Guia Hidrofílico


CPRE

em Nitinol Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicado como acessório auxiliar na introdução de instrumentos e cateteres em procedimentos gastroenterológicos e urológicos.

Fabricado em nitinol, revestido em PTFE, que reduz a fricção no canal de trabalho do endoscópio, com ponta em formato de jota ou reta, radiopaca, com presença de tungstênio, nos diâmetros 0,80 e 0,88 mm e comprimentos de 1500, 2300, 2600, 4500 e 4600 mm. O revestimento hidrofílico permite ao fio guia deslizar-se com facilidade através de instrumentos e cateteres de uso não vascular.

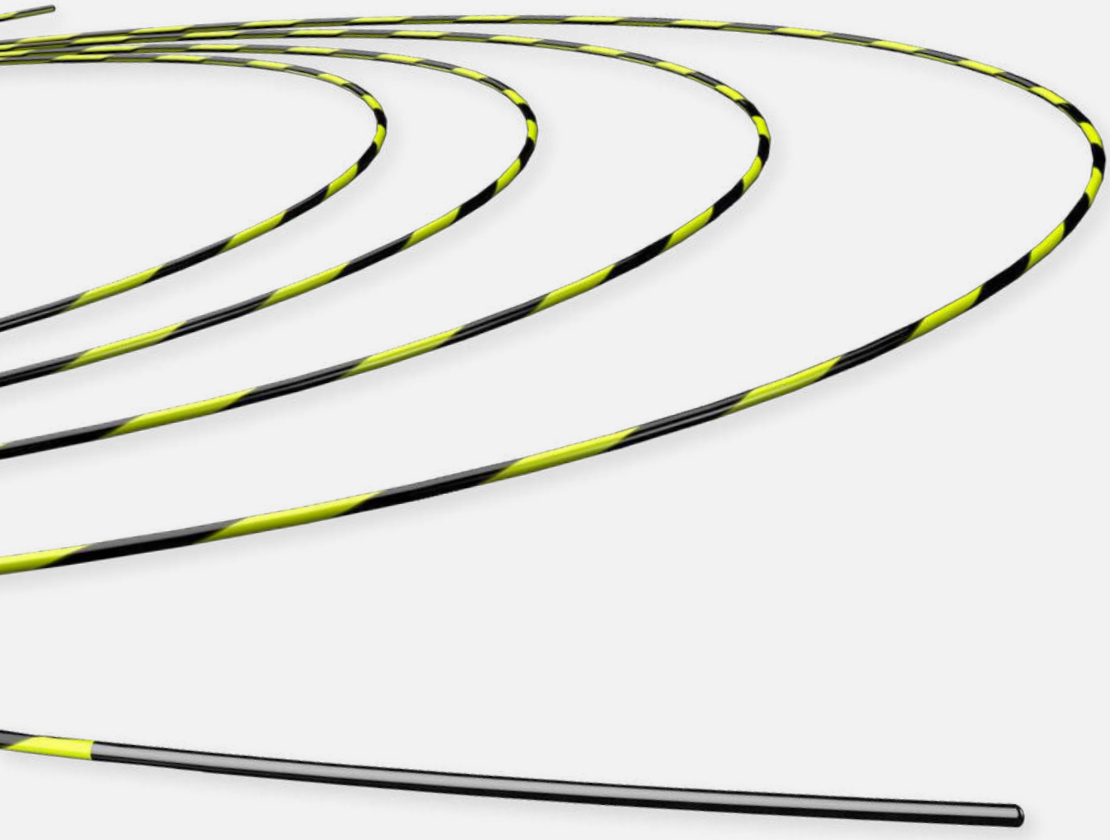

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Guia Hidrofílico

em Nitinol Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂMETRO	COMPRIMENTO	TIPO DE PONTA
JHY-ZGW-88-150-A	0,88 mm	1500 mm	Reta
JHY-ZGW-88-230-A	0,88 mm	2300 mm	Reta
JHY-ZGW-88-260-A	0,88 mm	2600 mm	Reta
JHY-ZGW-88-450-A	0,88 mm	4500 mm	Reta
JHY-ZGW-88-460-A	0,88 mm	4600 mm	Reta
JHY-ZGW-88-150-J	0,88 mm	1500 mm	Jota
JHY-ZGW-88-230-J	0,88 mm	2300 mm	Jota
JHY-ZGW-88-260-J	0,88 mm	2600 mm	Jota
JHY-ZGW-88-450-J	0,88 mm	4500 mm	Jota
JHY-ZGW-88-460-J	0,88 mm	4600 mm	Jota
JHY-ZGW-80-150-A	0,80 mm	1500 mm	Reta
JHY-ZGW-80-230-A	0,80 mm	2300 mm	Reta
JHY-ZGW-80-260-A	0,80 mm	2600 mm	Reta
JHY-ZGW-80-450-A	0,80 mm	4500mm	Reta
JHY-ZGW-80-460-A	0,80 mm	4600 mm	Reta
JHY-ZGW-80-150-J	0,80 mm	1500 mm	Jota
JHY-ZGW-80-230-J	0,80 mm	2300 mm	Jota
JHY-ZGW-80-260-J	0,80 mm	2600 mm	Jota
JHY-ZGW-80-450-J	0,80 mm	4500mm	Jota
JHY-ZGW-80-460-J	0,80 mm	4600 mm	Jota

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

Cateter Balão Endoscópico

CPRE


Biliar Jiuhong

Informações técnicas:

Indicado para remoção de cálculos no ducto biliar com um balão e infusão de meio de contraste, durante procedimentos endoscópicos.

Fabricado em PEBAX, com 7 Fr de diâmetro externo por 200 cm de comprimento de trabalho, com três vias de acesso, sendo uma para a introdução do fio guia (vendido separadamente), a segunda para infusão de meio de contraste e a terceira para insuflação do balão. O cateter possui, em sua extremidade distal, um balão fabricado em látex natural, com dois marcadores radiopacos, um orifício central para o fio guia (vendido separadamente) e um orifício lateral para a infusão, posterior ao balão.

O cateter acompanhada três seringas que determinam o diâmetro da insuflação do balão.

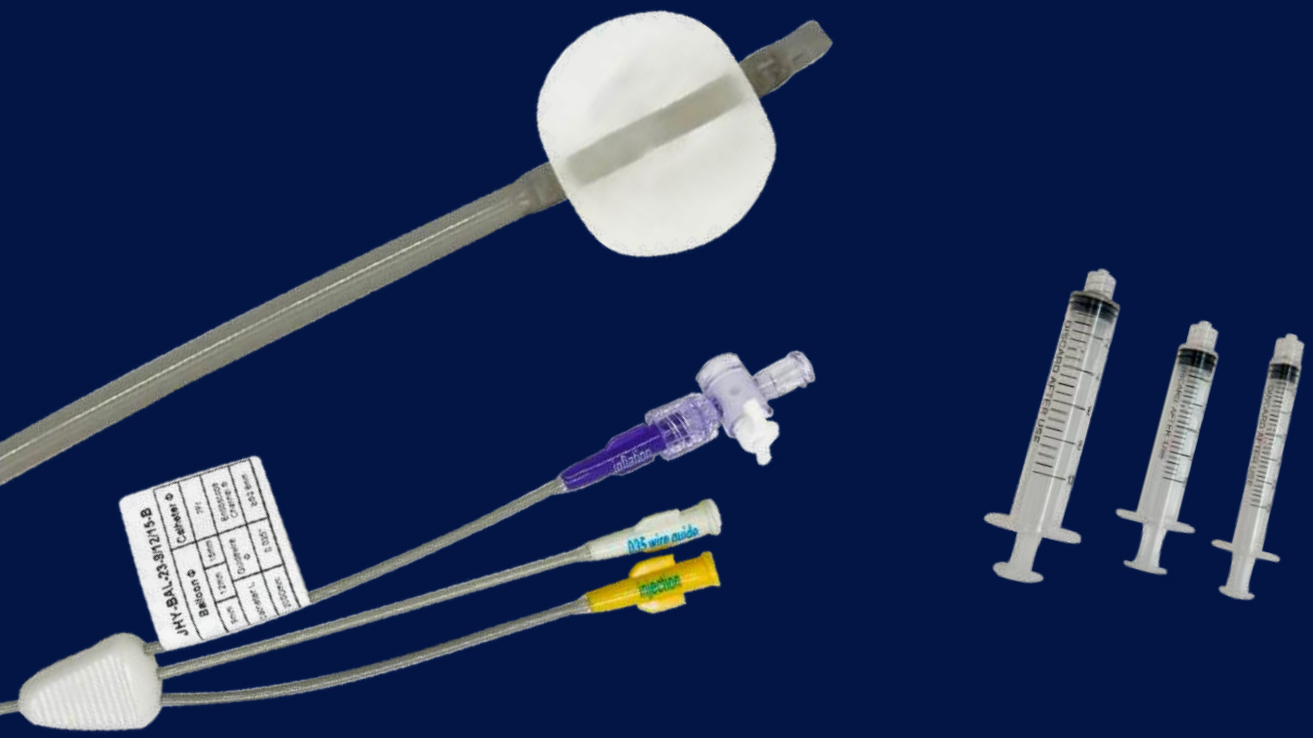

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão Endoscópico

Biliar Jiuhong

CÓDIGO	DIÂM. DO CATETER	COMP. DE TRABALHO	DIÂM. EXT. DO CATETER	CANAL DO ENDOSCÓPICO
JHY-BAL-23-8.5/11.5/15B	7 Fr	200 cm	8.5/11.5/15 mm	>=2.8 mm
JHY-BAL-23-9/12/15B	7 Fr	200 cm	9/12/15 mm	>=2.8 mm
JHY-BAL-23-11/13/15B	7 Fr	200 cm	11/13/15 mm	>=2.8 mm
JHY-BAL-23-10/13/16B	7 Fr	200 cm	10/13/16 mm	>=2.8 mm

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

Cateter Balão de Dilatação

CPRE

3 estágios Medika

Informações técnicas:

Indicado para dilatação de estruturas do trato digestivo durante procedimentos endoscópicos.

Fabricado em Pebax com 2.4 mm de diâmetro por 180; 200 e 230 cm de comprimento, para dilatação do trato digestivo por meio de balão hidrostático de alta patência, fabricado em Pebax, disponível nos diâmetros progressivos de 6/7/8; 8/9/10; 10/11/12; 12/13.5/15; 15/16.5/18 e 18/19/20 mm por 30, 55 e 80 mm de comprimento, com 02 marcadores radiopacos em liga de platina, conexão luer lock em ABS para insuflação do balão e conexão para o guia metálico. O balão possui marcadores radiológicos, para garantir localização precisa.



Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Cateter Balão de Dilatação

3 estágios Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ZKMB18-06/30-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/30-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/30-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-608-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-06/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 06-07-08 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-628-1024 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/30-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/30-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/30-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Cateter Balão de Dilatação

3 estágios Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ZKMB18-08/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-08/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 08-09-10 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-557-912 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/30-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/30-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/30-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Cateter Balão de Dilatação

3 estágios Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ZKMB18-10/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-10/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 10-11-12 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-507-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/30-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/30-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/30-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-12/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 12-13.5-15 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-811 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Cateter Balão de Dilatação

3 estágios Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
ZKMB18-15/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-15/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-15/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-15/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-15/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-15/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 15-16.5-18 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-709 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/55-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/55-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/55-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 55 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/80-180	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 180 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/80-200	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 200 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.
ZKMB18-18/80-230	01 cateter 2.4 mm de diâmetro x 230 cm de comprimento em Pebax com um balão de dilatação em Pebax, 3 estágios 18-19-20 mm de diâmetro e 80 mm de comprimento, com pressão de trabalho 304-456-608 Kpa, com conexão para insuflação do balão e para o guia metálico.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Vedtome Esfincterótomo

CPRE

Descartável

Informações técnicas:

Indicado para acessar o esfíncter duodenal por meio de um endoscópio, permitindo a incisão no esfíncter com o uso de corrente elétrica de alta frequência e a tração do fio de corte.

Composto por empunhadura, conector do eletrodo, conector de injeção de líquido, conector de fio-guia, tubo externo, fio de corte, tubo de fixação e fio de sustentação.

Disponível em duas versões: ponta tipo arco e tipo agulha. Ambas as versões possuem comprimentos de 700, 1100, 1900 e 2000 mm, com comprimento da ponta tipo agulha de 5 mm e da ponta tipo arco de 3, 7, 15 e 30 mm. O comprimento do fio de corte é de 2 mm na versão tipo agulha e de 20, 25, 30 e 35 mm na versão tipo arco. Compatível com canais de endoscópios com diâmetro igual ou superior a 2,8 mm.





MODELO AGULHA



MODELO ARCO

Fabricante: Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO			
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0320070-A	3	20	700
VDK-KE-0325070-A	3	25	700
VDK-KE-0330070-A	3	30	700
VDK-KE-0335070-A	3	35	700
VDK-KE-0720070-A	7	20	700
VDK-KE-0725070-A	7	25	700
VDK-KE-0730070-A	7	30	700
VDK-KE-0735070-A	7	35	700
VDK-KE-1520070-A	15	20	700
VDK-KE-1525070-A	15	25	700
VDK-KE-1530070-A	15	30	700
VDK-KE-1535070-A	15	35	700
VDK-KE-3020070-A	30	20	700
VDK-KE-3025070-A	30	25	700
VDK-KE-3030070-A	30	30	700
VDK-KE-3035070-A	30	35	700
VDK-KE-0320110-A	3	20	1100
VDK-KE-0325110-A	3	25	1100
VDK-KE-0330110-A	3	30	1100
VDK-KE-0335110-A	3	35	1100

Fabricante: Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO			
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0720110-A	7	20	1100
VDK-KE-0725110-A	7	25	1100
VDK-KE-0730110-A	7	30	1100
VDK-KE-0735110-A	7	35	1100
VDK-KE-1520110-A	15	20	1100
VDK-KE-1525110-A	15	25	1100
VDK-KE-1530110-A	15	30	1100
VDK-KE-1535110-A	15	35	1100
VDK-KE-3020110-A	30	20	1100
VDK-KE-3025110-A	30	25	1100
VDK-KE-3030110-A	30	30	1100
VDK-KE-3035110-A	30	35	1100
VDK-KE-0320190-A	3	20	1900
VDK-KE-0325190-A	3	25	1900
VDK-KE-0330190-A	3	30	1900
VDK-KE-0335190-A	3	35	1900
VDK-KE-0720190-A	7	20	1900
VDK-KE-0725190-A	7	25	1900
VDK-KE-0730190-A	7	30	1900
VDK-KE-0735190-A	7	35	1900

Fabricante: Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO			
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-1520190-A	15	20	1900
VDK-KE-1525190-A	15	25	1900
VDK-KE-1530190-A	15	30	1900
VDK-KE-1535190-A	15	35	1900
VDK-KE-3020190-A	30	20	1900
VDK-KE-3025190-A	30	25	1900
VDK-KE-3030190-A	30	30	1900
VDK-KE-3035190-A	30	35	1900
VDK-KE-0320200-A	3	20	2000
VDK-KE-0325200-A	3	25	2000
VDK-KE-0330200-A	3	30	2000
VDK-KE-0335200-A	3	35	2000
VDK-KE-0720200-A	7	20	2000
VDK-KE-0725200-A	7	25	2000
VDK-KE-0730200-A	7	30	2000
VDK-KE-0735200-A	7	35	2000
VDK-KE-1520200-A	15	20	2000
VDK-KE-1525200-A	15	25	2000
VDK-KE-1530200-A	15	30	2000
VDK-KE-1535200-A	15	35	2000

Fabricante: Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Vedtome Esfincterótomo

Descartável

MODELO: PONTA TIPO ARCO			
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA PONTA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-3020200-A	30	20	2000
VDK-KE-3025200-A	30	25	2000
VDK-KE-3030200-A	30	30	2000
VDK-KE-3035200-A	30	35	2000

MODELO: PONTA TIPO AGULHA			
CÓDIGO	COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DA FACA (MM)	COMPRIMENTO DO FIO DE CORTE (MM)	COMPRIMENTO DE TRABALHO (MM)
VDK-KE-0002070-B	5	2	700
VDK-KE-0002110-B	5	2	1100
VDK-KE-0002190-B	5	2	1900
VDK-KE-0002200-B	5	2	2000

Fabricante: Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd.
País: China

medika®
www.medika.com.br

Endoloop


Medika


Informações técnicas:

Indicado para a inserção de um anel de ligadura com o objetivo de prevenir ou controlar o sangramento após a remoção de um pólipo pediculado do trato digestivo, realizada por meio de procedimento endoscópico.

Cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo por 165, 195 e 230 cm de comprimento, extremidade distal com um gancho de tração, que transporta o anel de ligadura.

Acompanha 01 ou 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida, com abertura de 15, 20, 30 e 40 mm de diâmetro externo.

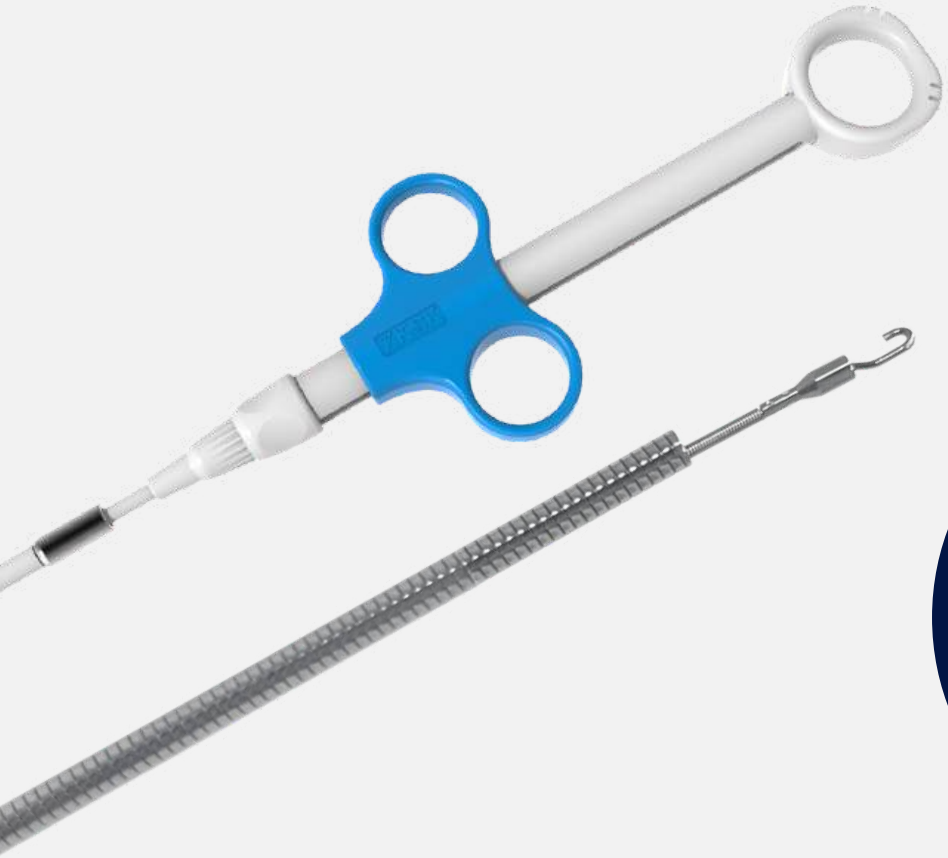

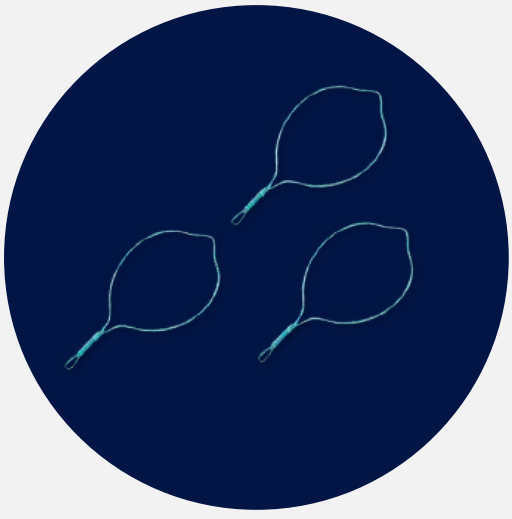

ANÉIS DE LIGADURA

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE15-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE20-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE30-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE30-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE40-165-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-195-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 03 anéis de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-230-3	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE15-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.
HE15-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 15 mm de diâmetro externo.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika
www.medika.com.br

Endoloop

Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
HE20-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE20-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 20 mm de diâmetro externo.
HE30-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 165 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE30-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 30 mm de diâmetro externo.
HE40-165-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-195-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 195 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.
HE40-230-1	01 cateter de estrutura helicoidal contínua em aço inoxidável envolvida por uma bainha de revestimento em PTFE, 2.5 mm de diâmetro externo x 230 cm de comprimento, com extremidade distal com um gancho de tração, que transporta um anel de ligadura. 01 anel de ligadura, fabricados em poliamida. com abertura de 40 mm de diâmetro externo.

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

Cateter Balão Endoscópico


Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicado para dilatação do trato digestivo por meio do canal de trabalho de um endoscópio.

Fabricado em Nylon com opções de diâmetro 2, 3,5 ou 4 mm e comprimentos de 900, 1100, 1800, 2000, 2300 e 2600 mm, para dilatação do trato digestivo utilizando um balão hidrostático de alta patência.

O balão é fabricado em nylon, disponível nos diâmetros 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 e 35 mm ou diâmetros progressivos de 6/7/8, 8/9/10, 10/11/12, 12/13/15, 12/13.5/15, 15/16/18 e 18/19/20 mm com comprimentos variando entre 40, 60 e 80 mm. Possui 2 marcadores radiopacos em platina, conexão luer lock em ABS para insuflação do balão e conexão para o fio guia metálico.

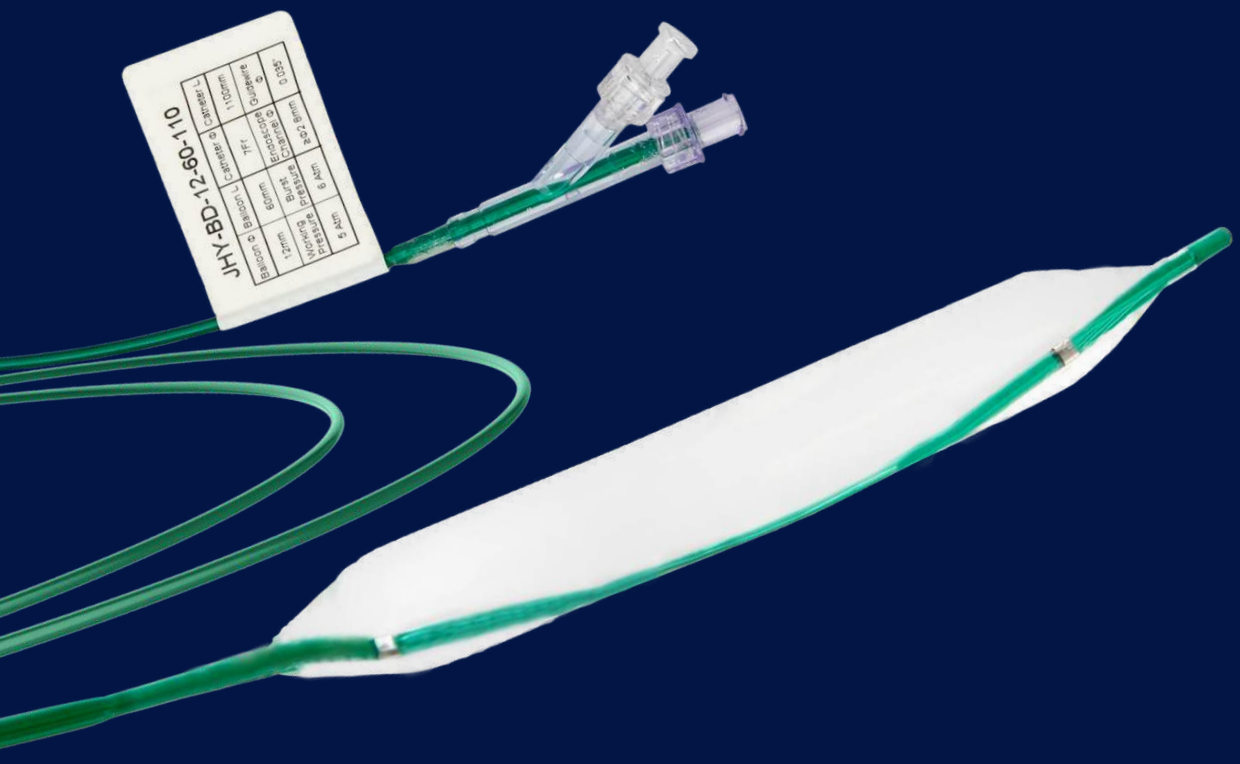

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão Endoscópico

Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂM. DO BALÃO	COMP. DO BALÃO	DIÂM. DO CATETER	COMP. DO CATETER	PRESSÃO DE TRABALHO (ATM)	PRESSÃO DE RUPTURA (ATM)
JHY-BD-06-40-90	6 mm	40 mm	2,4 mm	900 mm	8	13
JHY-BD-06-40-110	6 mm	40 mm	2,4 mm	1100 mm	8	13
JHY-BD-06-40-180	6 mm	40 mm	2,4 mm	1800 mm	8	13
JHY-BD-06-40-200	6 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	8	13
JHY-BD-06-40-230	6 mm	40 mm	2,4 mm	2300 mm	8	13
JHY-BD-06-40-260	6 mm	40 mm	2,4 mm	2600 mm	8	13
JHY-BD-6/7/8-40-200	6/7/8 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	3/6/10	12
JHY-BD-08-40-90	8 mm	40 mm	2,4 mm	900 mm	8	13
JHY-BD-08-40-110	8 mm	40 mm	2,4 mm	1100 mm	8	13
JHY-BD-08-40-180	8 mm	40 mm	2,4 mm	1800 mm	8	13
JHY-BD-08-40-200	8 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	8	13
JHY-BD-08-40-230	8 mm	40 mm	2,4 mm	2300 mm	8	13
JHY-BD-08-40-260	8 mm	40 mm	2,4 mm	2600 mm	8	13
JHY-BD-8/9/10-40-200	8/9/10 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	3/5, 5/9	11
JHY-BD-10-40-90	10 mm	40 mm	2,4 mm	900 mm	8	13
JHY-BD-10-40-110	10 mm	40 mm	2,4 mm	1100 mm	8	13
JHY-BD-10-40-180	10 mm	40 mm	2,4 mm	1800 mm	8	13
JHY-BD-10-40-200	10 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	8	13
JHY-BD-10-40-230	10 mm	40 mm	2,4 mm	2300 mm	8	13
JHY-BD-10-40-260	10 mm	40 mm	2,4 mm	2600 mm	8	13
JHY-BD-10/11/12-60-200	10/11/12 mm	40 mm	2,4 mm	2000 mm	3/5/8	10

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika®
www.medika.com.br

Cateter Balão Endoscópico

Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂM. DO BALÃO	COMP. DO BALÃO	DIÂM. DO CATETER	COMP. DO CATETER	PRESSÃO DE TRABALHO (ATM)	PRESSÃO DE RUPTURA (ATM)
JHY-BD-12-60-90	12 mm	60 mm	2,4 mm	900 mm	6	10
JHY-BD-12-60-110	12 mm	60 mm	2,4 mm	1100 mm	6	10
JHY-BD-12-60-180	12 mm	60 mm	2,4 mm	1800 mm	6	10
JHY-BD-12-60-200	12 mm	60 mm	2,4 mm	2000 mm	6	10
JHY-BD-12-60-230	12 mm	60 mm	2,4 mm	2300 mm	6	10
JHY-BD-12-60-260	12 mm	60 mm	2,4 mm	2600 mm	6	10
JHY-BD-12/13/15-60-200	12/13/15 mm	60 mm	2,4 mm	2000 mm	3/4,5/8	10
JHY-BD-12/13/15-80-180	12/13.5/15 mm	80 mm	2,4 mm	1800 mm	3/5/8	10
JHY-BD-14-60-90	14 mm	60 mm	2,4 mm	900 mm	5	9
JHY-BD-14-60-110	14 mm	60 mm	2,4 mm	1100 mm	5	9
JHY-BD-14-60-180	14 mm	60 mm	2,4 mm	1800 mm	5	9
JHY-BD-14-60-200	14 mm	60 mm	2,4 mm	2000 mm	5	9
JHY-BD-14-60-230	14 mm	60 mm	2,4 mm	2300 mm	5	9
JHY-BD-14-60-260	14 mm	60 mm	2,4 mm	2600 mm	5	9
JHY-BD-15/16/18-80-200	15/16/18 mm	80 mm	2,4 mm	2000 mm	3/4,5/7	10
JHY-BD-16-80-90	16 mm	80 mm	2,4 mm	900 mm	4	7
JHY-BD-16-80-110	16 mm	80 mm	2,4 mm	1100 mm	4	7
JHY-BD-16-80-180	16 mm	80 mm	2,4 mm	1800 mm	4	7
JHY-BD-16-80-200	16 mm	80 mm	2,4 mm	2000 mm	4	7
JHY-BD-16-80-230	16 mm	80 mm	2,4 mm	2300 mm	4	7
JHY-BD-16-80-260	16 mm	80 mm	2,4 mm	2600 mm	4	7

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

Cateter Balão Endoscópico

Jiuhong Medical

CÓDIGO	DIÂM. DO BALÃO	COMP. DO BALÃO	DIÂM. DO CATETER	COMP. DO CATETER	PRESSÃO DE TRABALHO (ATM)	PRESSÃO DE RUPTURA (ATM)
JHY-BD-18-80-90	18 mm	80 mm	2,4 mm	900 mm	4	8
JHY-BD-18-80-110	18 mm	80 mm	2,4 mm	1100 mm	4	8
JHY-BD-18-80-180	18 mm	80 mm	2,4 mm	1800 mm	4	8
JHY-BD-18-80-200	18 mm	80 mm	2,4 mm	2000 mm	4	8
JHY-BD-18-80-230	18 mm	80 mm	2,4 mm	2300 mm	4	8
JHY-BD-18-80-260	18 mm	80 mm	2,4 mm	2600 mm	4	8
JHY-BD-18/19/20-80-200	18/19/20 mm	80 mm	2,4 mm	2000 mm	3/4,5/6	8
JHY-BD-20-60-90	20 mm	60 mm	2,4 mm	900 mm	4	7
JHY-BD-20-60-110	20 mm	60 mm	2,4 mm	1100 mm	4	7
JHY-BD-20-60-180	20 mm	60 mm	2,4 mm	1800 mm	4	7
JHY-BD-20-60-200	20 mm	60 mm	2,4 mm	2000 mm	4	7
JHY-BD-20-60-230	20 mm	60 mm	2,4 mm	2300 mm	4	7
JHY-BD-20-60-260	20 mm	60 mm	2,4 mm	2600 mm	4	7
JHY-BD-20-80-90	20 mm	80 mm	2,4 mm	900 mm	4	7
JHY-BD-20-80-110	20 mm	80 mm	2,4 mm	1100 mm	4	7
JHY-BD-20-80-180	20 mm	80 mm	2,4 mm	1800 mm	4	7
JHY-BD-20-80-200	20 mm	80 mm	2,4 mm	2000 mm	4	7
JHY-BD-20-80-230	20 mm	80 mm	2,4 mm	2300 mm	4	7
JHY-BD-25-80-90	25 mm	80 mm	3,5 mm	900 mm	2,5	4
JHY-BD-30-80-90	30 mm	80 mm	3,5 mm	900 mm	2,5	4
JHY-BD-35-80-90	35 mm	80 mm	3,5 mm	900 mm	2,5	4

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

Dispositivo para Ligadura Elástica

por Endoscopia com Conector de Irrigação Medika

Informações técnicas:

Indicado para procedimentos de hemostasia de varizes esofágicas por via endoscópica, na junção gastroesofágica ou acima deste local ou para laquear hemorroidas internas.

A técnica consiste em ocluir as varizes com uma banda elástica, interrompendo o sangramento.

Dispositivo composto por uma manopla de acionamento e disparo com conector de irrigação e presilha para endoscópio, um tambor com bandas elásticas pré carregadas, em látex, adaptador para irrigação, fio carregador com 159 cm e um cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal.



Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Dispositivo para Ligadura Elástica

por Endoscopia com Conector de Irrigação Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
BL18-4AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 4 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal
BL18-5AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 5 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal
BL18-6AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 6 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal
BL18-7AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 7 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal
BL18-8AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 8 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal
BL18-9AP	1 Manopla com conector de irrigação e presilha, 1 tambor com 9 bandas elásticas pré carregadas, em látex, 1 adaptador de irrigação, 1 fio carregador com 159 cm, 1 cateter de inserção com 160 cm com alça distal e proximal

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Bocal para Endoscopia

com Presilha Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicado para proteger a cavidade oral do paciente e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

Fabricado em polipropileno, descartável, com abertura com 2,5 cm de largura x 2,0 cm de altura, com presilha e fita elástica sintética, com 55 cm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha.



Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Bocal Descartável

para Endoscopia com Presilha Medika - BB003

Informações técnicas:

Indicado para proteger a cavidade oral do paciente e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

Fabricado em polipropileno, descartável, com abertura com 2,5 cm de largura x 2,0 cm de altura e 2,6 cm de comprimento, com presilha e fita elástica sintética, com 34 cm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha.



Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br

Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

Informações técnicas:

Indicado para proteger a cavidade oral e o endoscópio durante procedimentos gastroendoscópicos.

Fabricado em polipropileno, descartável, com abertura oval ou retangular nos tamanhos 71mm x 32,5mm; 76 mm x 55,5 mm; 88 mm x 42,8 mm e 88 mm x 55,5 mm, com presilha e fita elástica sintética, com 455 e 605 mm de comprimento e orifícios para encaixe na presilha.



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

Informações técnicas:



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR



MODELO OVAL



MODELO RETANGULAR

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Bocal para Endoscopia

com Presilha Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO
AC01-103.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 76 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-103.A	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 88 mm x 42,8 mm, retangular, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-103.P	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 71 mm x 32,5 mm, retangular, com presilha e fita elástica sintética com 455 mm.
AC01-108.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 88 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 605 mm.
AC01-109.M	01 bocal para endoscopia fabricado em polipropileno, 76 mm x 55,5 mm, oval, com presilha e fita elástica sintética com 605 mm.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China


Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio Medika

Informações técnicas:

Indicada para limpeza do canal de trabalho de endoscópios com 2,0, 2,8 e 3,2 mm de diâmetro, descartável, com comprimentos de tubo de 2300 mm.

O corpo da escova é fabricado em poliacetal (POM), com cerdas em nylon.

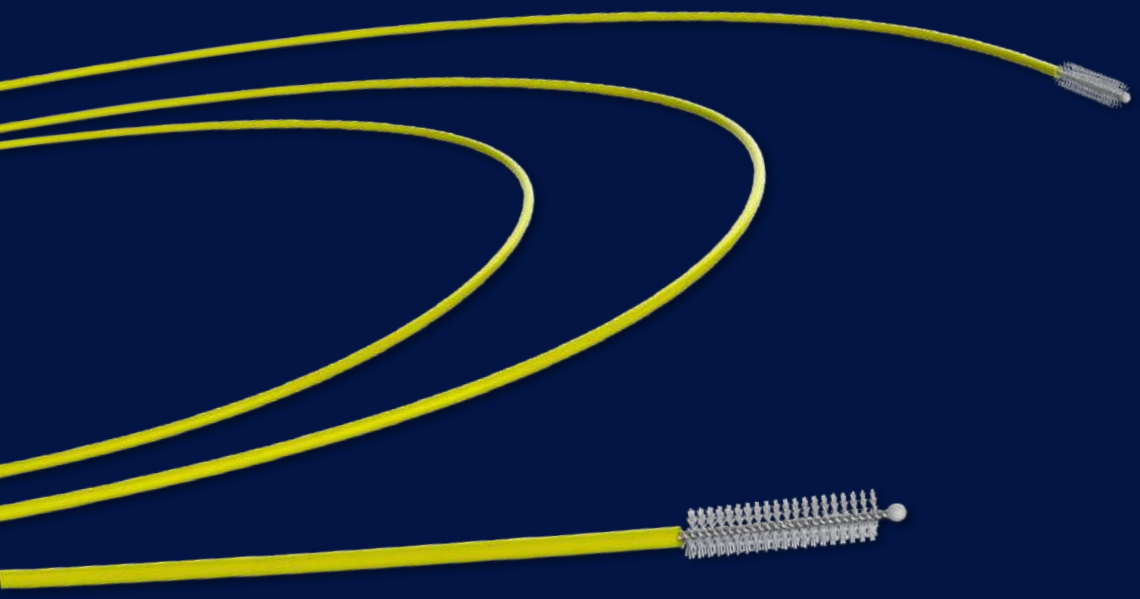

Fabricante: Beijing ZKSK Technology Co., Ltd.,
País: China

medika®
www.medika.com.br


Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio Jiuhong Medical

Informações técnicas:

Indicada para limpeza do canal de trabalho de endoscópios, disponível nas versões dupla escova e tripla com diâmetros 2,0, 2,8 e 3,2 mm, com comprimentos de tubo de 1200, 1800, 2300 mm.

O corpo da escova é fabricado em poliacetal (POM), com cerdas em nylon.

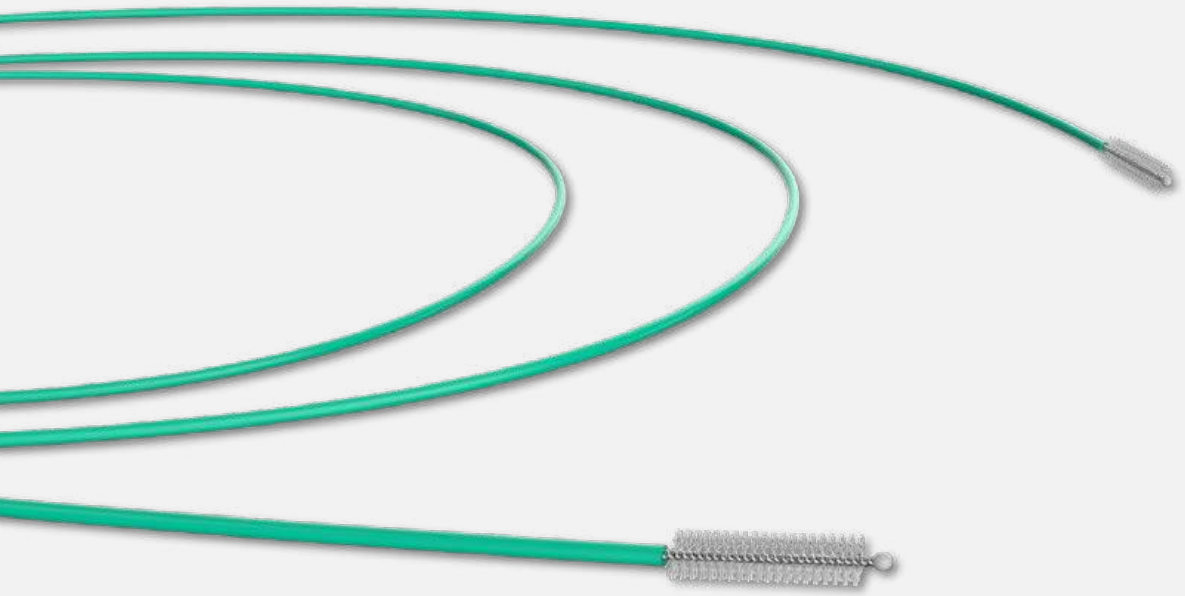

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China

medika
www.medika.com.br

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio Jiuhong Medical

MODELO: TRIPLA ESCOVA			
CÓDIGO	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO (mm)	COMPRIMENTO DO TUBO (mm)	DIÂMETRO DA ESCOVA (mm)
JHY-CB-06-180-D	2.8-3.2	1800	06
JHY-CB-06-230-D	2.8-3.2	2300	06
JHY-CB-03-120-D	2.0	1200	03
JHY-CB- 03-180-D	2.0	1800	03

MODELO: DUPLA ESCOVA			
CÓDIGO	CANAL DE TRABALHO DO ENDOSCÓPIO (mm)	COMPRIMENTO DO TUBO (mm)	DIÂMETRO DA ESCOVA (mm)
JHY-CB-06-180-C	2.8-3.2	1800	06
JHY-CB-06-230-C	2.8-3.2	2300	06
JHY-CB-03-120-C	2.0	1200	03
JHY-CB- 03-180-C	2.0	1800	03

Fabricante: Changzhou Jiuhong Medical
País: China


medika
www.medika.com.br

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio e Válvula Medika

Informações técnicas:

Escova para limpeza de canal de trabalho e válvula de endoscópios, descartável, com comprimento de tubo de 2300 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon.

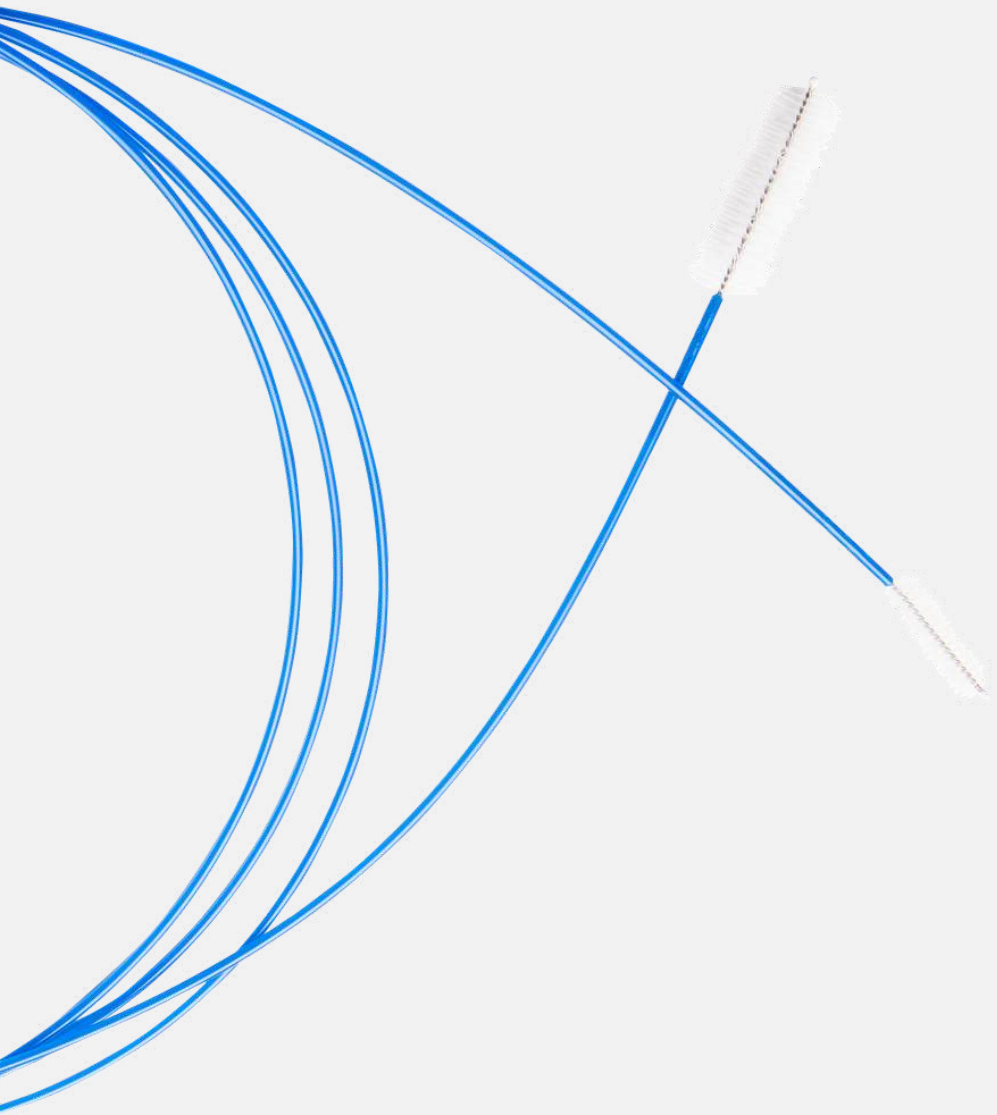



MODELO ESCOVA DUPLA
Cerdas com tamanhos iguais



MODELO ESCOVA DUPLA
Cerdas com tamanhos diferentes

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio e Válvula Medika

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CB18-5010/23	01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 10 mm e 05 mm, com cerdas em nylon.
CB18-5050/23	01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 05 mm, com cerdas em nylon.
CB18-6060/23	01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com dupla escova de 06 mm, com cerdas em nylon.


Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio e Válvula Medika

Informações técnicas:

Escova para limpeza de canal de trabalho e válvula de endoscópios, descartável, com comprimento de tubo de 2300 mm. O corpo da escova, no modelo escova e rodo, é fabricado em silicone, com cerdas em nylon.

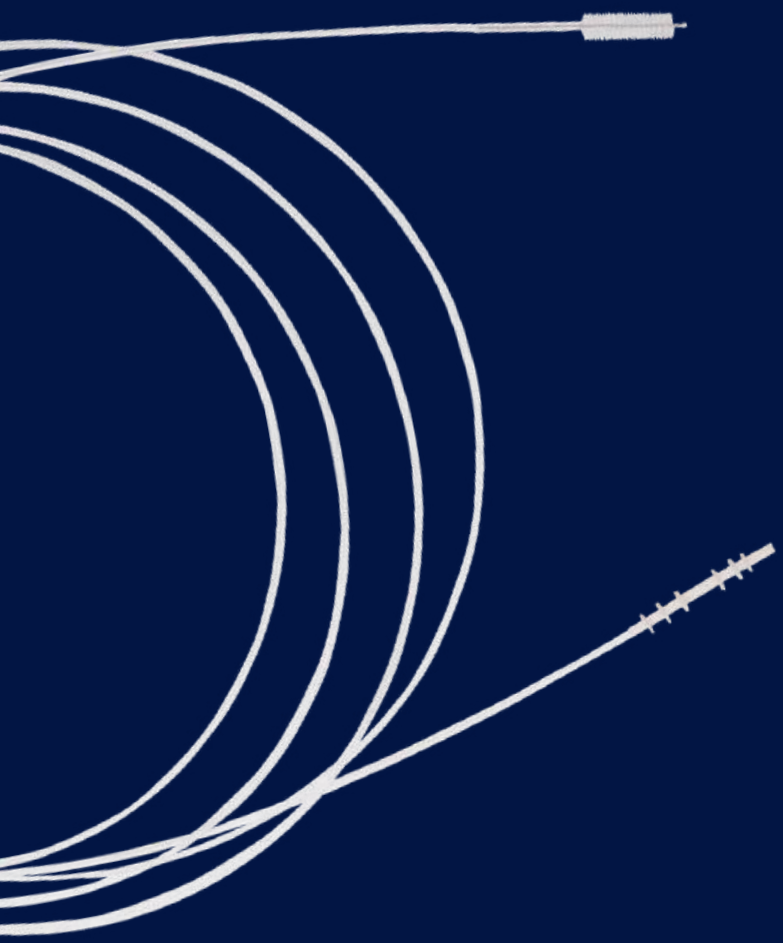



MODELO ESCOVA E RODO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CB18-4550/23	01 escova de limpeza para canal de trabalho de endoscópio, 2300 mm de comprimento, com escova de cerdas em nylon 05 mm e rodo de 4.5 mm, de silicone.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China


medika®
www.medika.com.br

Escova de Limpeza

para Canal de Trabalho do Endoscópio e Válvula Medika

Informações técnicas:

Escova para limpeza de canal de trabalho e válvula de endoscópios, descartável, com comprimento de tubo de 155 mm. O corpo da escova é fabricado em POM, com cerdas em nylon.

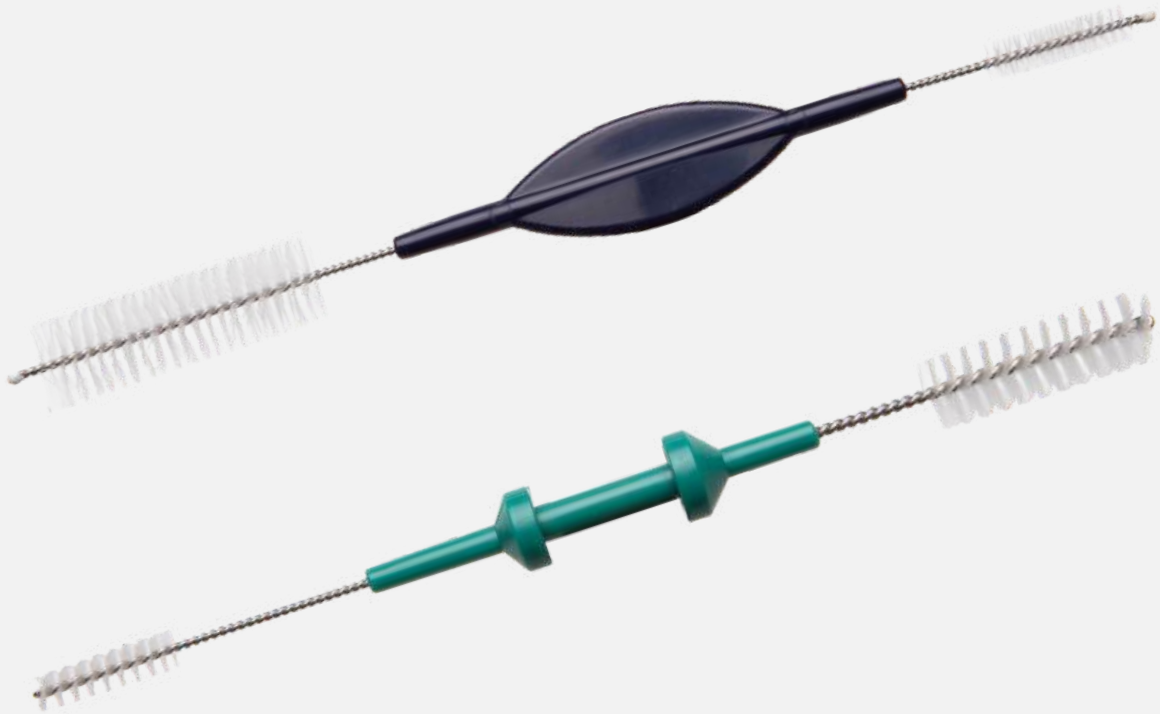


CÓDIGO	DESCRIÇÃO
CB13-5010/02	01 escova de limpeza curta para válvula de endoscópio, 155 mm de comprimento, com dupla escova de 05 e 10 mm, com cerdas em nylon.
CB13-50120/02	01 escova de limpeza curta para válvula de endoscópio, 155 mm de comprimento, com dupla escova de 05 e 12 mm, com cerdas em nylon.

Fabricante: Changzhou Pharos Medical Technology Co.Ltd.
País: China

medika
www.medika.com.br















www.medika.com.br